


[病院・福祉施設用]

耐熱保温漆器ワカ・プロテックの取扱い上の注意

- 機械で洗浄される際には、温度管理に注意して下さい。
自動洗浄機をご使用の場合は、必ず **85℃以下**として下さい。
熱風消毒保管庫をご使用の場合は、熱風吹き出し口付近での温度が
設定温度よりも上がり過ぎる場合がありますので、温度管理には十分
ご注意下さい。
(温度管理 80℃～85℃以下 30 分間)
- 予備洗浄を行って下さい。
カレー・ケチャップ・カラン等の食品は、色素が着色しやすいので、
予備洗浄を行ってから本洗浄を行って下さい。特に、これらの色素が
着色しやすい食品はご注意ください。
- 金属タワシ・磨き粉などは使用しないで下さい。
クレンザーやスチールワールなどの使用はキズの原因になりますので
避けて下さい。
柔らかいスポンジ等をご使用下さい。
- 直接火で熱しないで下さい。
変形・変質防止のため、直火・オープンや電熱器などの近くに置く
ことは避けて下さい。
- 乱暴な扱いはしないで下さい。
残菜落としの際の投げ・ぶつけ・こすりなどは、キズ・破損の原因に
なりますのでご注意ください。
- 重い物を乗せたり高く積み上げる事はしないで下さい。
- 長期間にわたる薬品への浸け込みには注意して下さい。
(変色する場合があります。)
- 直射日光にさらして置くことや、湿度の高い所に置くことは
避けて下さい。
(変形、変色、カビ等の原因になる場合があります。)
- 電子レンジには、ご使用にならないで下さい。

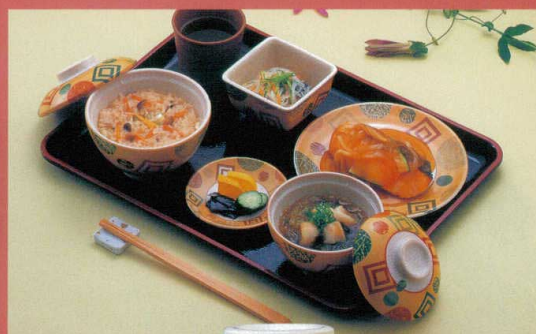

上手な使い方

- お料理を盛り付ける前に食器を温めておくと、より効果的です。
- 温かいうちに盛り付けをして、調理熱を逃がさないように早く蓋をして下さい。
- できるだけ早く配膳することによって、調理後のおいしさを一層保ちます。

ワカ・プロテックは、病院・施設それぞれにオリジナルの

「塗り、色、デザイン」が出来ます。

また、名入れ(ネーム)も承りますので、特注品・費用等につきましては、
販売店までお問い合わせ下さい。

品名 検査 05-124901号
平成7年 7月 6日

試験検査成績書

受検者 株式会社 〇〇〇
試験項目 耐熱性試験
試験結果 合格
試験場所 〇〇〇試験センター
試験員 〇〇〇

試験項目	試験結果	試験場所	試験員
耐熱性試験	合格	〇〇〇試験センター	〇〇〇

検査方法 A24 "2" 400 125
備考

品名 検査 05-124901号
平成7年 7月 6日

試験検査成績書

受検者 株式会社 〇〇〇
試験項目 耐熱性試験
試験結果 合格
試験場所 〇〇〇試験センター
試験員 〇〇〇

試験項目	試験結果	試験場所	試験員
耐熱性試験	合格	〇〇〇試験センター	〇〇〇

検査方法 A24 "2" 400 125
備考

確かな品質と、高い安全性。

美しい光沢、なめらかな手ざわり。

一つ一つ豊富な実績と、最新の技術によって創り上げられた
プロテックの器は、食品衛生法(合成樹脂製の器具及び食品規格)に
基づき、厳密な衛生試験を定期的実施しておりますので確かな品質と
高い安全性であるプロテック製品をお届け致しております。